ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ


Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации инструментов и приборов - www.bienair.com

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
В АВТОКЛАВЕ КЛАССА В


рекомендуем MELAquick или Vacuklav фирмы MELAG




ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

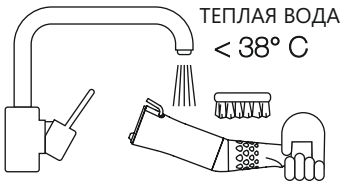

СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ **LUBRIFLUID**



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА **AQUACARE**

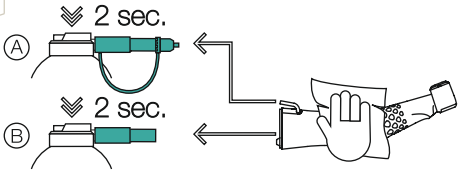

ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

рекомендуем MELAtherm 10 фирмы MELAG






ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА **AQUACARE**



РУЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ



НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА **SPRAYNET**




ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА **SPRAYNET**



ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ ИНСТРУМЕНТОВ

Снимите бор и оставьте (запирающий механизм) в открытом положении, затем отсоедините инструмент от микромотора

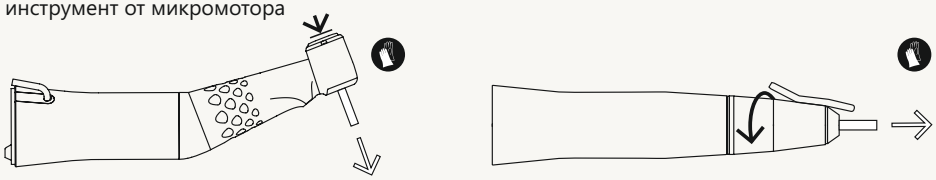


СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для получения более подробной информации о совместимости с системами технического обслуживания (других поставщиков), свяжитесь с BA


НАКОНЕЧНИКИ УГЛОВЫЕ ДЛЯ ХИРУРГИИ




CA 20:1 L Micro-Series 1600692 | CA 20:1 L 1600598 | CA 20:1 1600632 | CA 1122 1600603 | CA 20:1 L KM Micro-Series 1600786 | CA 20:1 L KM 1600785

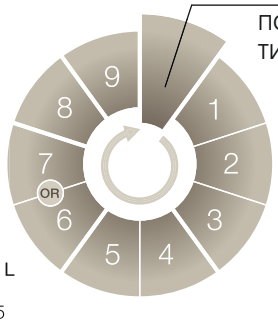

ПОДГОТОВКА УГЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ С СИСТЕМОЙ ТИПА КИРШНЕР - МАЙЕР.

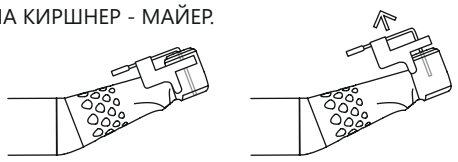

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Максимум после 10 стерилизаций система типа Киршнер-Майер подлежит утилизации




НАКОНЕЧНИКИ УГЛОВЫЕ



CA 1:1 L Micro-Series 1600691 | CA 1:1 L 1600384 | CA 1:1 1600424 | CA 10:1 L 1600385 | CA 10:1 1600425 | CA 1:5 L Micro-Series 1600690 | CA 1:5 L 1600386 | CA 1:5 1600325



ПОДГОТОВКА



Прочистите отверстия подачи воды/воздуха с помощью чистящей иглы компании Bien-Air

СМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПО УХОДУ НА ОБОРОТЕ (НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПО УХОДУ ЗА ПРЯМЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ НАКОНЕЧНИКАМИ BIEN AIR

НАКОНЕЧНИКИ ПРЯМЫЕ




PM 1:1
Micro-Series
1600693



PM 1:1
1600383



ПОДГОТОВКА




Прочистите отверстия подачи воды/воздуха с помощью чистящей иглы компании Bien-Air



PM 1:1
1600052



ПОДГОТОВКА




Прочистите трубку распылителя с помощью чистящей иглы компании Bien-Air



PM 1:2
1600436



ПОДГОТОВКА



Снимите муфту распылителя и одноразовую муфту Bur Guard. Утилизируйте муфту Bur Guard. Прочистите внешний распылитель с помощью чистящей иглы компании Bien-Air.



Прочистите трубку распылителя с помощью чистящей иглы компании Bien-Air

СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА НАКОНЕЧНИКАМИ BIEN AIR



Aquacare
500 мл чистящее средство
в виде спрея, в уп. 6 шт.
для очистки инструментов, исполь-
зуемых с физиологическим раствором
арт. 1600617-001



Spraynet
500 мл чистящее средство
в виде спрея, в уп. 6 шт.
для очистки инструментов и приборов
арт. 1600036-001



Lubrifluid
500 мл смазочное средство
в виде спрея, в уп. 6 шт.
для турбин, механических наконечников и
моторов серии MX, Basch и Aquilon.
арт. 1600064-001



Чистящая игла
Для прочистки каналов распылителей турбин,
угловых и прямых наконечников.
Идет в комплекте с каждым наконечником
Так же можно приобрести отдельно, в уп. 10 шт
арт. 1000001-010

WWW.BIENAIR.COM